


# 合成、精製から濃縮までの時間を1/3に！ Biotage製品でスタイリッシュに効率化



# Biotageの 魅力的な装置群

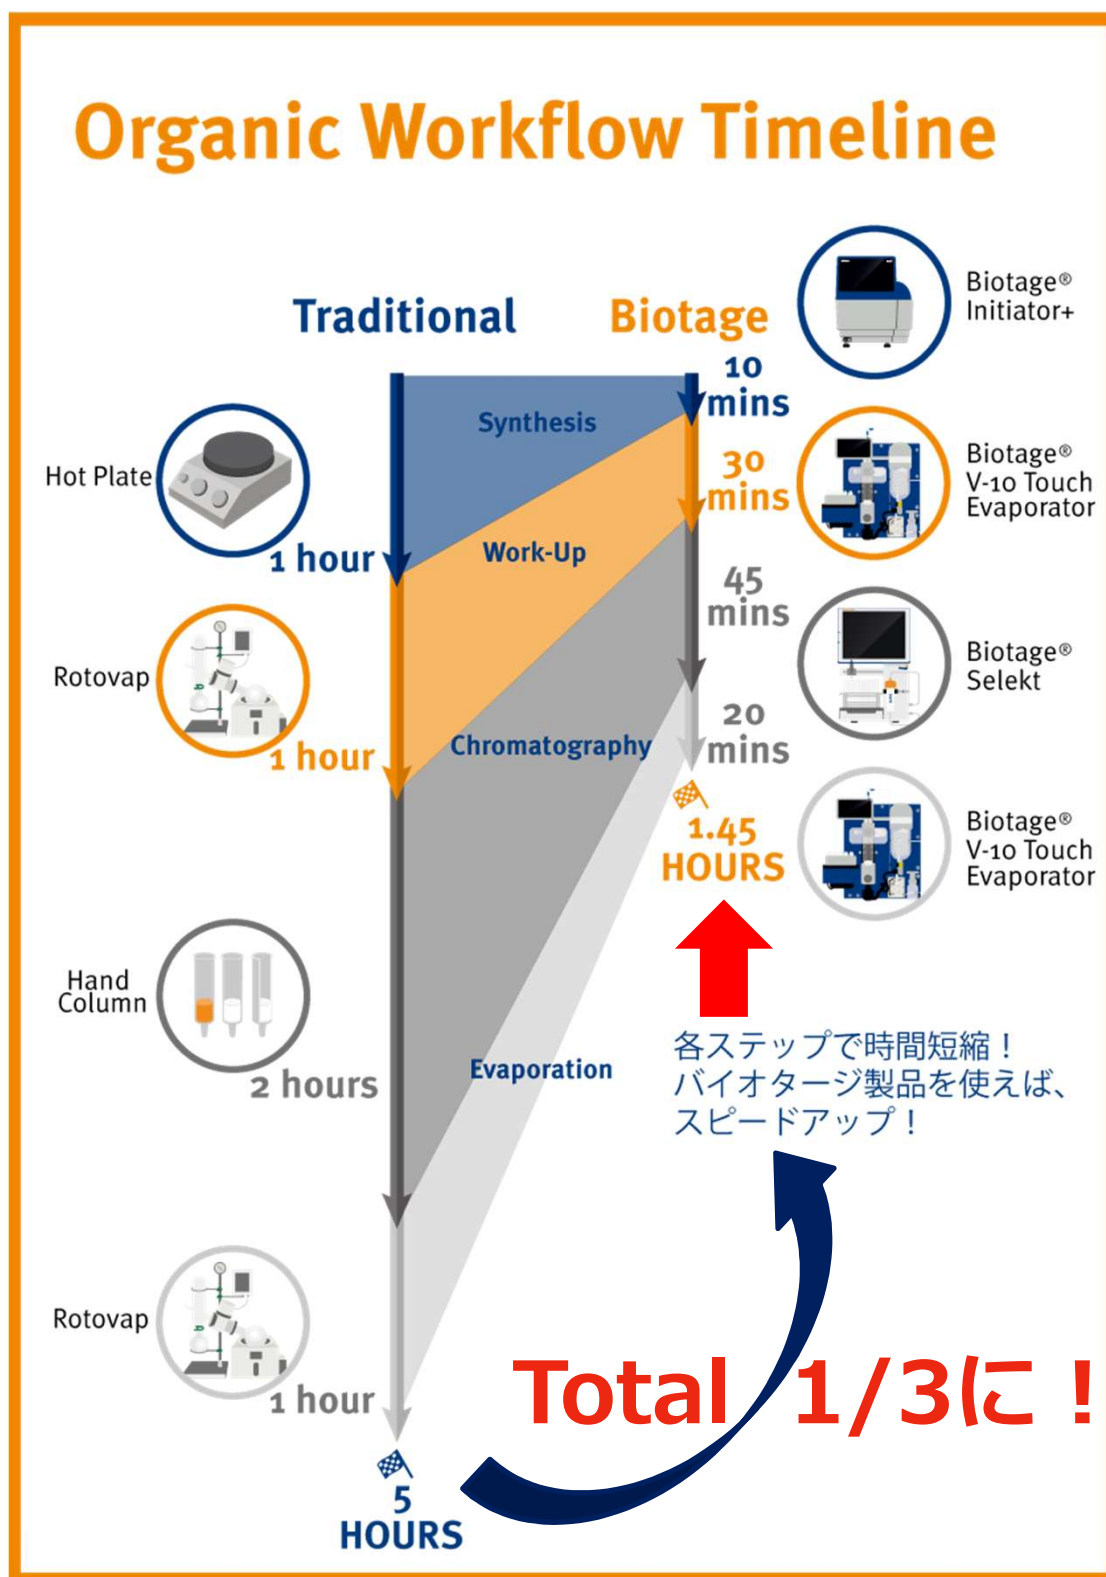

マイクロウェーブ合成装置  
Initiator+



高速エバポレーションシステム  
V-10 Touch\*

With Biotage

Synthesis:  
10 mins



Initiator+

Work-Up:  
30 mins



V-10 Touch Evaporator

\* ) 高沸点溶媒が多いほど、  
従来法に比べて濃縮が早く  
終了します。

Chromatography:  
45 mins



Selekt

1.45  
hours

Evaporation:  
20 mins



V-10 Touch Evaporator



最新超高速フラッシュ自動精製システム  
Biotage® Selekt

システム構成等、ニーズに合ったご提案をさせていただきます。  
詳細はお問い合わせください。

<https://www.biotage.co.jp>



バイオタージジャパン株式会社

本社: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F  
TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28, 4F  
TEL 06-6397-8180 FAX 06-6397-8170

URL: <https://www.biotage.co.jp/> E-mail: [Japan\\_info@biotage.com](mailto:Japan_info@biotage.com)

Biomark124 Organic Timeline

© Biotage 2020

  
Biotage®